

**DESCRIEREA MODELULUI MIJLOACELOR DE MĂSURARE PENTRU  
REGISTRUL DE STAT AL MIJLOACELOR DE MĂSURARE PERMISE SPRE  
UTILIZARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA**

**APROBAT**

**Director al INM**



Anatolie MELENCIUC

L. S. "19" 02 2018

**APARAT DE MĂSURARE A  
ETANOLULUI DIN AERUL  
EXPIRAT (ETILOMETRE)  
tip Alcotest 5820**

**Inclus în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare  
permise spre utilizare în Republica Moldova**

**Nr. de înregistrare I-0893:2018**

**Fabricat conform** documentației producătorului.

**DESTINAȚIE ȘI DOMENIU DE APLICARE:** Aparatul de măsurare a etanolului din aerul expirat (etilometre) tip Alcotest 5820 (în continuare – etilometru) este destinat pentru măsurarea concentrației masice de etanol în aerul expirat. Etilometrul este utilizat în domeniul de interes public.

**DESCRIERE:** Prințipiu de măsurare al etilometrului este bazat pe aplicarea traductorului electrochimic, cu ajutorul căruia să măsoară concentrația etanolului în aerul expirat. Etilometrul are în componență un traductor de presiune cu ajutorul căruia se măsoară durata și debitul de aer care trece prin muștiuc. În baza datelor despre volumul și concentrația etanolului se calculează concentrația masică a etanolului în aerul expirat. Etilometrul este un instrument portabil cu afisaj digital usor de folosit. În afară de rezultatul măsurării pe ecran se indică regimurile de lucru și nivelul de încărcare a elementelor de alimentare. Dirijarea etilometrului se efectuează cu ajutorul a trei taste, care sunt plasate pe panoul frontal al analizatorului. Alimentarea electrică se efectuează de la baterie sau de la acumulator reîncarcabil. Etilometrul este echipat cu dispozitiv de memorie pentru 100 măsurări.



**Fig.1 Aspectul exterior**

**CARACTERISTICILE TEHNICE ȘI METROLOGICE DE BAZĂ** sunt prezentate mai jos:

Tabelul 1


Denumirea caracteristicii	Valoarea
Intervalul de măsurare a concentrației de etanol, mg/l	de la 0,00 până la 2,50 mg/l (La depășirea intervalului de măsurare etilometrul indică: ↑ . ↑ ↑ )
Timpul minimal pentru suflare, s, (selectabil)	2
Volumul minimal suflat, l, (selectabil)	1,2
Timpul intrării în regim de lucru după conectare, s	2
Timpul de recuperare după efectuarea măsurărilor în funcție de concentrațiile alcoolului, s :	
0,25 mg/l	20
0,50 mg/l	40
1,00 mg/l	80
>1,5 mg/l	120
Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C	de la -5 până la +50
Umiditatea relativă, %	de la 10 până la 100
Presiunea atmosferică, kPa	de la 60 până la 130
Temepratura de păstrare, °C	de la -20 până la +70
Dimensiunile de gabarit, mm	50/60 x 141 x 31
Masa, g	aprox. 150
Clasa de protecție	IP 54

Tabelul 2

Intervalul de măsurare a concentrației masice de etanol, mg/l	Limita tolerată a erorii	
	eroarea absolută	eroarea relativă
Până la 0,400	± 0,020 mg/l	-
De la 0,400 până la 2,000	-	± 5,0 %
Mai mult de 2,000	-	± 20,0 %

**MARCAJUL APROBĂRII DE MODEL:** Se aplică pe carcasa mijlocului de măsurare (fig.2, pct. 1) și pe pașaportul național prin metoda tipografică.

**COMPLETARE:** Setul de livrare conform documentației producătorului.

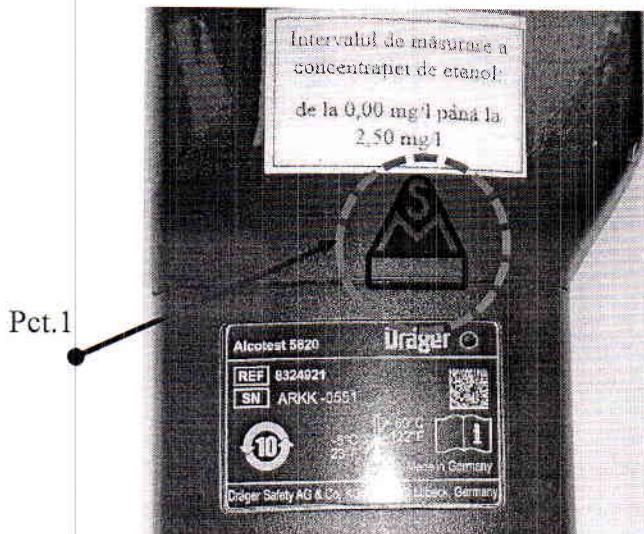


**Fig. 2 Locul de aplicare a marcajului aprobării de model**

**VERIFICARE METROLOGICĂ:** Se efectuează în conformitate cu NML R 126:2009.

În cazul rezultatelor pozitive ale verificării metrologice:

- Se aplică marcajul de verificare metrologică prin aplicarea etichetei autocolante, destruitibilă prin dezlipire, stampilată (fig.3, pct.1);
- Se eliberează buletin de verificare metrologică conform RGML 12:2013.

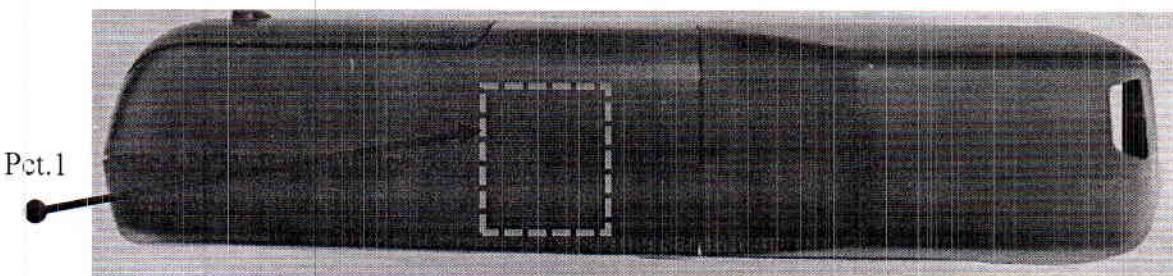

**Fig.3 Locul de aplicare a marcajului de verificare metrologică.**

În cazul rezultatelor negative a verificării metrologice se eliberează buletin de inutilizabilitate, conform RGML 12:2013.

**DOCUMENTE NORMATIVЕ:** NML R 126:2009.

**CONCLUZIE:** Aparatul de măsurare a etanolului din aerul expirat (etilometre) tip Alcotest 5820 corespunde cerințelor NML R 126:2009.

**PRODUCĂTOR:** Dräger Safety AG & Co. KgaA, Republica Federală Germania.

Şef adjunct Direcția Metroologie Legală

(semnătura)

Diana Bejenaru

(prenumele, numele)

Executor

(semnătura)

Tudor Popa

(prenumele, numele)

Solicitantul

(semnătura)

Alexandru Ermicev

(prenumele, numele)